


(12) ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์

(21) เลขที่คำขอ 2301006026 (22) วันที่ยื่นคำขอ 22 กันยายน 2566	(51) สัญลักษณ์จำแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ Int.Cl.10 F24F 5/00, F24F 13/00
(31) เลขที่คำขอที่ยื่นครั้งแรก - (32) วันที่ยื่นคำขอครั้งแรก - (33) ประเทศที่ยื่นคำขอครั้งแรก -	(71) ผู้ขอรับสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (72) ผู้ประดิษฐ์ ศาสตราจารย์ไพศาล นาผล นายสหัสวรรษ ภูจิระ นายนายอภิชาติ ศรีชาติ นายอนุวัติ ศรีเจริญพานิชย์ (74) ตัวแทน นางสาวนิยดา รุ่งเรืองผล 114 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
(54) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ เครื่องปรับอากาศสำหรับที่นอนผู้ป่วยติดเตียง (57) บทสรุปการประดิษฐ์ เครื่องปรับอากาศสำหรับที่นอนผู้ป่วยติดเตียง เป็นการออกแบบเครื่องปรับอากาศสำหรับที่นอนผู้ป่วยติดเตียง โดยใช้หลักการทำความเย็นจากแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริกส์ ซึ่งลมเย็นที่ได้ถูกป้อนผ่านระบบท่ออากาศที่ติดตั้งภายในที่นอนผู้ป่วยติดเตียง ช่วยลดอุณหภูมิและความชื้นภายในที่นอน ในกรณีหน้าร้อนที่ต้องการทำความเย็น และสามารถสลับเป็นลมร้อนผ่านระบบท่ออากาศที่ติดตั้งภายในที่นอนผู้ป่วยติดเตียง ช่วยทำความอุ่นและลดความชื้นภายในที่นอน ในกรณีหน้าหนาวที่ต้องการทำความร้อน ซึ่งการปรับอากาศสำหรับที่นอนที่เหมาะสมกับผู้ป่วย สามารถช่วยลดปัญหาการเกิดแผลกดทับได้	

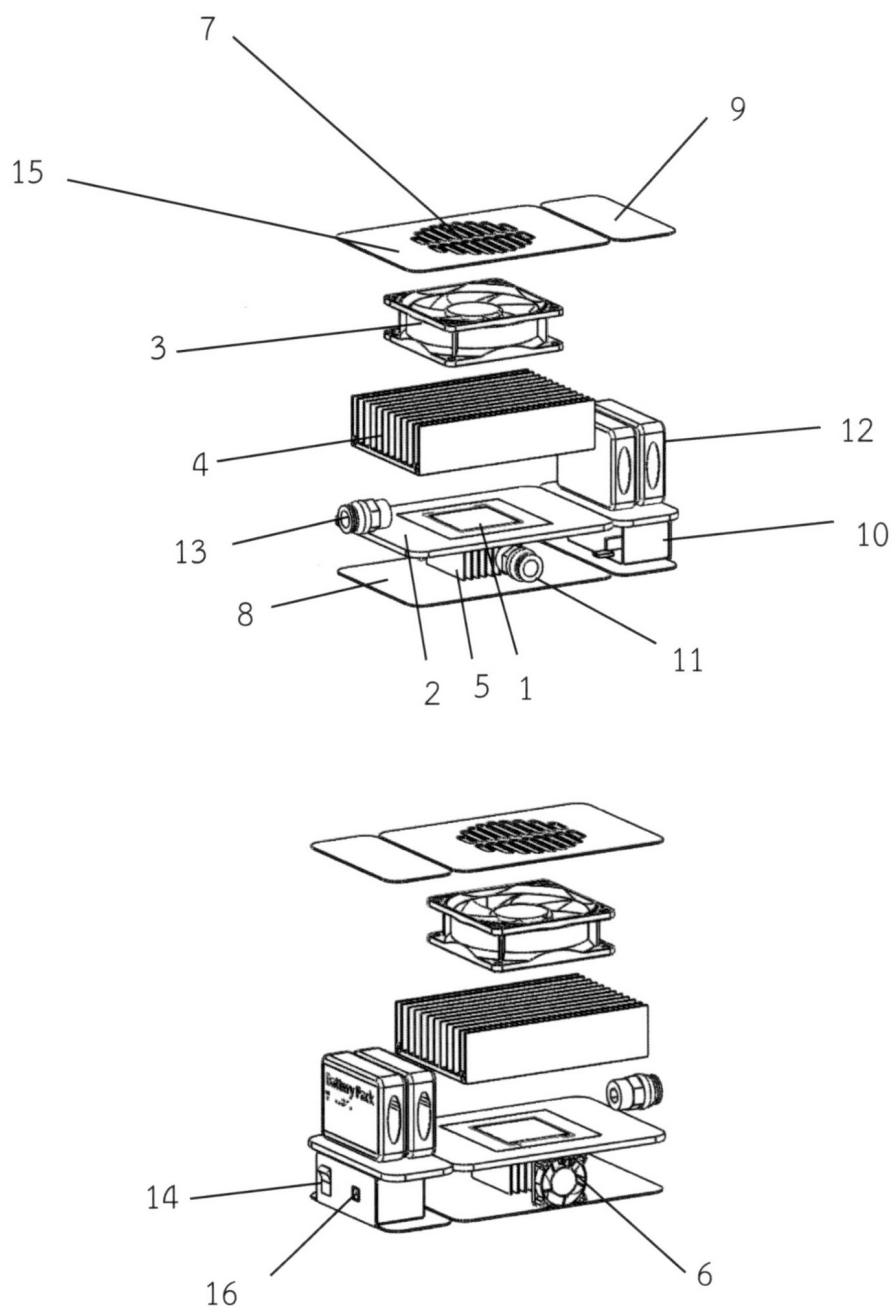

รูปที่ 1